

Płock, dnia 22.02. 2019 roku

PZOZ/DZP/382/09PN/19

### Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

#### Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.

#### Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 1, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.

#### Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 1, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.

#### Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran pakowanych po 6 szt. w kopercie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.

#### Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µm o powierzchni lepnej 34x40cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µm o powierzchni lepnej 60x60cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 11 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z włókniny o wymiarach 9,14 x 2,5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 152x190cm z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x142 cm

-1 x kocik dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 195/260x305 cm +/- 2 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układająca się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/- 1cm

- 1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

- 1 x osłona na kończynę 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm

- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzoną w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów >200 cmH<sub>2</sub>O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm<sup>2</sup>). Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 19, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego odpornego na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 178cm H<sub>2</sub>O (rękawy), mankiety wykonane z doskonale dopasowującej się dzianiny. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie nadruku po obu stronach fartucha po rozpakowaniu go z włókniny. rozmiar L 120cm, rozmiar XL 140 cm, rozmiar XXL 150cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 19, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego odpornego na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 178cm H<sub>2</sub>O (rękawy), mankiety wykonane z doskonale dopasowującej się dzianiny. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w formie nadruku po obu stronach fartucha po rozpakowaniu go z włókniny. Rozmiar 2XXL 160cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**


**Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13x240 cm o grubości 0,05 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 22**

Prosimy o dopuszczenie systemu płukania pulsacyjnego jednorazowego użytku wyposażonego w port do podłączenia ssania i WBUDOWANĄ baterię, co eliminuje konieczność stosowania długich przewodów i zapewnia swobodę ruchu; Rękojeść ze zintegrowanym przewodem irygacyjnym oraz oddzielnym przewodem ssącym, w zestawie z krótką końcówką z osłoną rozbryzgową posiadającą długość 8,5cm, oraz długą końcówką do kanału kości udowej o dł. 19cm; regulowany spust szybkości- min lub max.

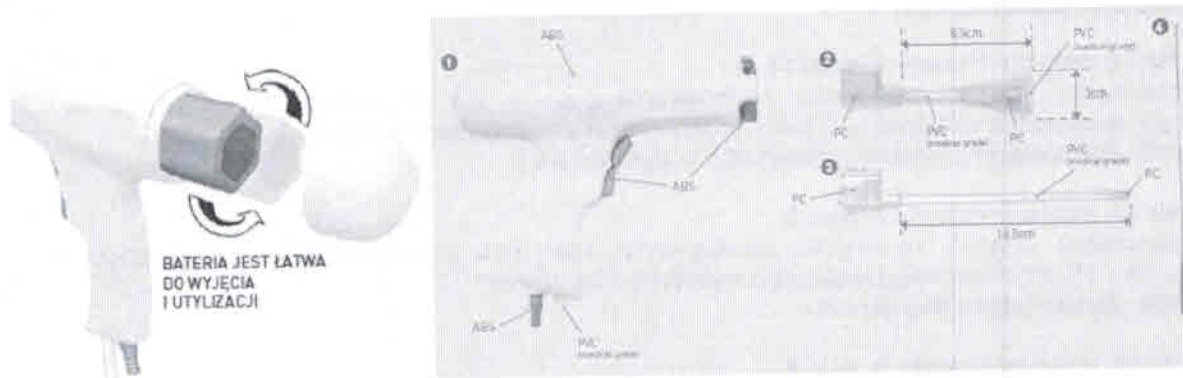

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów w chirurgii biodra, w którym łata chłonna, wokół pola operowanego jest w rozmiarze min. 100 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 14, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnioną folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia.

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze min. 75 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 18, poz.**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do artroskopii wykonanego z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>. Serweta posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 109,5 g/m<sup>2</sup>. Zdolność absorpcji cieczy wg EN ISO 9073-6, 405 mierzonej w ml/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów > 125 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 19, poz. 1, 2**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z zapięciem na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 19, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zgodnego z SIWZ z dodatkowymi 2 rękawkami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 20, Pkt 7. SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ppkt. 7.2.3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie dokumentu potwierdzającego właściwości bakteriobójcze w stosunku do szczepów MRSA, MRSE, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E.Coli – dotyczy pakietu 23.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie powyższego dokumentu pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi również dokument potwierdzający właściwości bakteriobójcze w stosunku do szczepów PRSP.**

**Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do bezurazowego zamykania ran pakowanych w opakowanie jałowe a' 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu na 5.**

**Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku poliuretanowego przylepnego w rozmiarze 15 x 15 cm, z warstwą piankową o wymiarze 10 x 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 14 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii biodra, wykonanego z laminatu 2-warstwowego ( PP-PE ) o min gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad min. 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie, wykonanego z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) o min gramaturze 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z jednym uchwytem do mocowania, z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad min. 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 14, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu pionowego, wykonanego z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) bez dodatkowych obszarów wzmocnionych, posiadający w swoim składzie serwetę narzędziową i serwetę na stolik Mayo wykonane z dwuwarstwowego laminatu PP-PE o gramaturze min. 90 g/m<sup>2</sup> ( bez dodatkowych wzmocnień ) o odporności na penetrację płynów > 150 cm H<sub>2</sub>O oraz 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP-PE o min. Gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/ mokro >161 kPa, wytrzymałości na penetrację płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta t do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (bez sztywnika) oraz oknem w kształcie nerki 29 x 19 cm wypełnionym

folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole) bez podłączenia ssaka i organizatora przewodów

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowego laminatu ( włóknina polipropylenowa- folia polietylenowa ) o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, chłonności warstwy zewnętrznej min. 285% oraz odporności na penetrację płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 16, poz. 2-5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa- folia polietylenowa ) o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, chłonności warstwy zewnętrznej min. 285% oraz odporności na penetrację płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 16, poz. 4-5**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycjach tych Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet z przylepcem czy bez przylepca?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwet bez przylepca.**

**Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 16, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 200 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 16, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 200 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 16, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze 95 x 120 cm lub 90 x 150 cm **LUB** serwety przylepnej w rozmiarze 90 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwety zgodnej z OPZ.**

**Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu 16, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 100 x 120 cm z 20 cm mankietem z torbą przechwytyjącą płyny?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z pakietu nr 16 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy możliwość wyboru rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw obłożeń operacyjnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń do artroskopii stawu barkowego o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285% oraz całkowitej chłonności warstwy zewnętrznej ze wzmocnieniami min. 350 %? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń do artroskopii o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285% oraz całkowitej chłonności warstwy zewnętrznej ze wzmocnieniami min. 350 % i następującym składzie:

- 1 x serweta wzmocniona 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm
- 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x bandaż elastyczny do wysokiej kompresji 12 cm x 5 m
- 1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu 19 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókny SMS o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy w strefie rękawów > 165 cm H<sub>2</sub>O, posiadającego w okolicach szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków. Fartuch posiada indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Długość fartuchów: 115 cm, 125 cm, 140 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu 19 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o długości 155 cm, wykonanego z włókny SMS o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy w strefie rękawów > 165 cm H<sub>2</sub>O, posiadającego w okolicach szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków. Fartuch posiada indywidualne oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry bez zmian.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z pakietu nr 16 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy możliwość wyboru rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw fartuchów chirurgicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 39, dotyczy Projektu umowy § 6, ust. 1**

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a i 1d do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
- §6 ust. 1b do kwoty 0,2 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia
- §6 ust. 1c do kwoty 0,2 % wartości reklamowanej części zamówienia.

Zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna występuje, więc wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej (np. określony procent wartości całego lub części świadczenia czy też określona stawka pomnożona przez liczbę dni zwłoki lub opóźnienia). Strony umową mogą wszakże zastrzec, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik będzie zobowiązany do innego niż pieniężne świadczenia, ale wówczas takie zastrzeżenie nie jest już karą umowną, a pełni jedynie funkcję gwarancyjną. W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego często są one ukształtowane korzystniej dla zamawiającego. To zamawiający dyktuje, jakie postanowienia znajdują się w umowie. Rola wykonawcy w kształtowaniu postanowień jest ograniczona do minimum. Zwrócić jednak należy na okoliczność, że określony zapis umowy dotyczący kary umownej może zostać uznany za sprzeczny z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Ta zasada w wyniku nowelizacji z 2016 r. (ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw z 22.06.2016 r.), została dodana do wskazanego przepisu i powinna również mieć wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. W kontekście formułowania zapisów umowy należy ją odczytywać jako nakaz stosowania takich zapisów umowy (w tym przypadku zapisów o karach), które są adekwatne i konieczne do osiągnięcia celu, w tym przypadku realizacji umowy. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu pewności, że umowa zostanie wykonana w terminie, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Zwrócić również należy na wyroki KIO w tym zakresie, m.in. na wyrok KIO z 25 października 2013 r., KIO 2397/13 - „Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Również w kolejnym wyroku KIO z dnia 27 marca 2014 r., KIO 487/14, Izba wskazała - „zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 40, dotyczy Projektu umowy § 6, ust. 2b**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 41, dotyczy Projektu umowy § 9, ust. 3**

W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%.

Wniosek powyższy wynika z faktu, iż brak ustalenia minimum realizowanych dostaw stanowi naruszenie art. 353<sup>1</sup> k.c. w zw. z art. 139 pzp oraz art. 29 ust. 2 pzp. Zaniechanie takiego zastrzeżenia przeczy bowiem zasadzie równości stron poprzez naruszenie zasady swobody umów, jak również nie spełnia

należytego określenia przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze zasady wskazane powyżej po stronie zamawiającego istnieje bowiem obowiązek określenia najbardziej precyzyjnie ilości jakie zostaną zrealizowane w 100% oraz zakres ilościowy z którego zrezygnuje. W tym zakresie zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak również KIO jest bezwzględne i wskazuje na obowiązek umieszczania zapisów gwarantujących minimalny poziom zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia..

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu 11 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 11 w pozycji 1 i 2 folie bakteriobójcze zawierały substancję aktywną co zgodnie z wymogiem ustawy o wyrobach medycznych potwierdzone jest deklaracją zgodności producenta dla wyrobu medycznego klasy III i certyfikatem jednostki notyfikowanej poświadczającym właściwość klasyfikacji dołączonych do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności producenta dla wyrobu medycznego klasy III wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej poświadczającym właściwość klasyfikacji i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu 11 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 11 w pozycji 1 i 2 dostarczenia wyrobu medycznego klasy III?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy III.**

**Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu 11 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 11 w pozycji nr 1 i 2 folie bakteriobójcze były pakowane w podwójne opakowanie indywidualne: papier zabezpieczający i folię aluminiową?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.**

**Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu 11 poz. 1 i 2**

Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 i 2 folie bakteriobójcze posiadały system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera? System ten znacznie zmniejsza ryzyko nieprawidłowej aplikacji folii i może przyczynić się do zmniejszenia ilości zakażeń miejsca operowanego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46, dotyczy pakietu nr 22**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w ilości 1 szt.? Asortyment jest używany i znany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 47, dotyczy Pakietu 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 48, dotyczy Pakietu 1, poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 49, dotyczy Pakietu 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 50, dotyczy Pakietu 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 51, dotyczy Pakietu 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 48.**

**Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu na 5.**

**Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,83g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,49g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,04g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 22x38cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 17x28cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 17x28cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 22x37cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 22x37cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 12x19cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe o wykroju min. 37x19cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe o wykroju min. 37x42cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 66, dotyczy Pakietu 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe o wykroju min. 28x34cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu 4, poz. 11.**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości 100-140%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu 4, poz. 12-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 69 dotyczy Pakietu 4, poz. 12-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu 4, poz. 17-19**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 71, dotyczy Pakietu 4, poz. 17-19**

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 72, dotyczy Pakietu 4, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73, dotyczy Pakietu 11, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 74, dotyczy Pakietu 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42x36cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 75, dotyczy Pakietu 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 66x46cm lub 70x74cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 76, dotyczy Pakietu 11, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 77, dotyczy Pakietu 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworek o średnicy 6cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 78, dotyczy Pakietu 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 79, dotyczy Pakietu 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

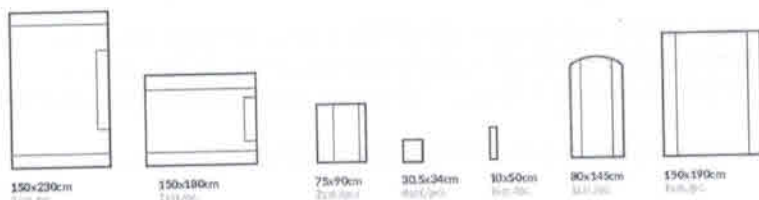

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 80, dotyczy Pakietu 16, poz. 2, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 81, dotyczy Pakietu 16, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o chłonności 350% oraz odporności na penetrację płynów 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 82, dotyczy Pakietu 16, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 83, dotyczy Pakietu 16, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 84, dotyczy Pakietu 16, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 85, dotyczy Pakietu 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji barku:

Servety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serveta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>. Serveta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

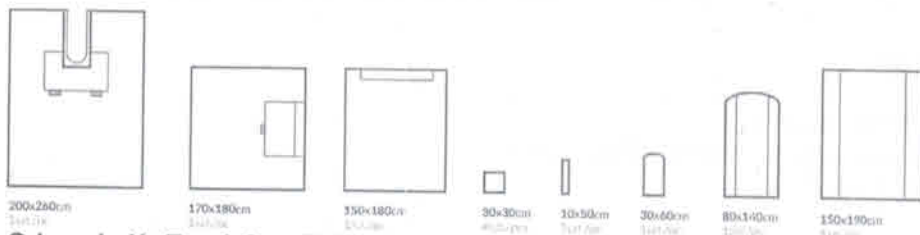

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 86, dotyczy Pakietu 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H<sub>2</sub>O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H<sub>2</sub>O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawym 3cm x 7cm, dostępny w rozmiarach M - 120cm, L - 128cm, XL - 138cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu 19, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H<sub>2</sub>O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H<sub>2</sub>O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawy 3cm x 7cm, w rozmiarze XXL - 157cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 88, dotyczy Pakietu 21**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z folii PE o grubości 0,05mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 89, dotyczy Pakietu 5**

- a) Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
- b) Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający nie wymaga, b) Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 90, dotyczy Pakietu 23**

- a) Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzaju parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.
- b) Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
- c) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pH w zakresie 2,5-3,5. Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli.
- d) Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:
- w całości pochodzenia roślinnego,
  - sterylizowane promieniami gamma,
  - nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
  - nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
  - działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone w instrukcji użytkowania;
  - działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
  - działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
  - hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
  - okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
  - posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
  - warunki przechowywania do 25 stopni?

**Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający dopuszcza dokument potwierdzający. Ad. b) Nie wymaga, ale dopuszcza, Ad. c) Zamawiający dopuszcza, Ad. d) Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 91, dotyczy Pakietu 23**

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o pH 2-4, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza hemostatyk o pH 2-4, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pytanie nr 92, dotyczy pkt. 7.2.2 SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga próbek do pakietów 12-22? Czy doszło tu do omyłki pisarskiej?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymaga próbek w powyższym zakresie, zgodnie z zapisem w pkt 7.2.2 siwz.

**Pytanie nr 93, dotyczy Pakietu 2, poz. 7,8,9**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze tupferów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie zbiorcze, pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnych opakowań oraz przy zachowaniu ilości wymaganych przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 94, dotyczy Pakietu 3, poz. 4**

Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny w op. do max 5 kg i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 95, dotyczy Pakietu 4, poz. 12-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 96, dotyczy Pakietu 4, poz. 17-19**

Czy Zamawiający dopuści rękawy bez zawartości bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 97, dotyczy Pakietu 4, poz. 17,18**

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 15m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 98, dotyczy Pakietu 4, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 14m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 99, dotyczy Pakietu 4, poz.20**

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w rogu serwety?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 100, dotyczy Pakietu 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm,
- 6 x tampony z gazy bawełnianej kula o wykroju 20x20cm,
- 1 x igłotrzymacz 13 cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm,
- 1 x strzykawka 10ml,
- 1 x igła 1,2mm x 40mm, 18G x 11/2, różowa,
- 1 x igła 0,8mm x 40mm, 21G x 11/2, zielona,
- 1 x serweta włókninowa foliowana 75cm x 45cm z otworem o średnicy 8cm,
- 1 x serweta celulozowa foliowana nieprzylepna 60cm x 50cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 101, dotyczy Pakietu 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> i wzmocnieniu 40g/m<sup>2</sup> z przodu i na rękawach, które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x13cm pętelki, a rozmiar jest naniesiony w postaci pieczętki, którą widać przed rozłożeniem fartucha?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 102, dotyczy Pakietu 19, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> i wzmocnieniu 40g/m<sup>2</sup> z przodu i na rękawach, które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x13cm pętelki, a rozmiar jest naniesiony w postaci pieczętki, którą widać przed rozłożeniem fartucha?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 103, dotyczy Pakietu Pakiet 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm w miejsce 150cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 104, dotyczy Projektu umowy § 6 ust. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 105, dotyczy Projektu umowy § 6 ust. 1b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

**Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 40**

**Pytanie nr 106, dotyczy Projektu umowy § 6 ust. 1d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 107, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie zamawianej ilości na 10 opakowań a`10szt tj. 100 sztuk w pozycji nr 1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 108, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie zamawianej ilości na 15 opakowań a`10 szt. tj. 150 sztuk w pozycji nr 2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 109, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie zamawianej ilości na 15 opakowań a`10 szt. tj. 150 sztuk w pozycji nr 3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 110, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie zamawianej ilości na 5 opakowań a`5szt tj. 25 sztuk w pozycji nr 4?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań do ilości wymaganej w SIWZ przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 111, dotyczy Pakietu 10**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.**

*Handwritten signature and initials.*

**Pytanie nr 112, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 113, dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 114, dotyczy Pakietu 3, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykroj 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykroj 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykroj 19 cm x 38 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 115, dotyczy Pakietu 3, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 116, dotyczy Pakietu 2, poz. 2-4**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 117, dotyczy Pakietu 2, poz. 2-4**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIa reg. 7?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 118, dotyczy Pakietu 2, poz. 3-4**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 119, dotyczy Pakietu 2, poz.1-4**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 120, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 121, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykroj 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykroj 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykroj 19 cm x 38 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 122, dotyczy Pakietu 4, poz.9-10**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z jedną zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 123, dotyczy Pakietu 4, poz.17-19**

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 124, dotyczy Pakietu 4, poz.17-19**

Czy Zamawiający ma na myśli 1 szt. =1 opakowaniu zawierającym około 10 mb siatki w stanie swobodnym?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający ma na myśli 1 szt.= 1 op. ok. 10 mb.**

**Pytanie nr 125, dotyczy Pakietu 4, poz.17-19**

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 126, dotyczy Pakietu 4, poz.17-19**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 127, dotyczy Pakietu 4, poz. 1-3,6-10,17-19**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,6-10,17-19 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji: 17-19 i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie nr 128, dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1-6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 129, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu nr 1 poz. 1-6 opatrunków pokrytych klejem hypoalergicznym poliakrylowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 130, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu nr 1 poz. 1 opatrunku o wymiarach 5x7cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 131, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu nr 1 poz. 2 opatrunku o wymiarach 10x10cm, w opakowaniu a'50szt, w ilości 150 opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 132, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie pakietu nr 1 poz. 3 opatrunku o wymiarach 10x10cm, w opakowaniu a'50szt, w ilości 100 opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 133, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do zabiegów w chirurgii biodra:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78 cm x 145 cm

2x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x300 cm z łatą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów

1 serweta operacyjna 100x150cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 cm x 120 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 230 cm x 260 cm z wycięciem "U" 20x85 cm, z łatą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 134, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do zabiegów na kończynie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 cm x 65 cm

2x taśma włókninowa samoprzylepna 9cm x 50 cm

1 serweta na kończynę 230cm x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z łatą chłonną 75x80cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 140g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 135, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do zabiegów na kończynie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 22 cm x 75 cm

1 serweta operacyjna 150x190cm (na stół do instrumentarium)

2x taśma włókninowa samoprzylepna 9cm x 50 cm

1 serweta na kończynę 230cm x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z łatą chłonną 50x100cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta: 2 x włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 75 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 155g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 136, dotyczy Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 137, dotyczy Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do cięcia cesarskiego :

1serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 186/250x330 cm posiadająca otwór o wymiarach 36x36 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie o wymiarach 18 x 16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 72x72 cm wyposażony w sztywnik,

1 serweta - owinięcie noworodka 75x120 cm,

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,

4 celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34 cm,

1 osłona na stolik Mayo 78 x 145 cm,

1 serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokr: 168/168 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa typu Tyvec z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. min. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 138, dotyczy Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do cięcia cesarskiego :

1serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 230x330 cm posiadająca otwór o wymiarach 36x36 cm, wypełniony folią chirurgiczną. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 102x112 cm wzmocniony gąbką, wyposażony w sztywnik aluminiowy, 4 organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta - owinięcie noworodka 75x120 cm,

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,

4 celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34 cm,

1 osłona na stolik Mayo 78 x 145 cm,

1 serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokr: 168/168 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa typu Tyvec z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. min. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 139, dotyczy Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 140, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 1 niżej opisanego zestawu?  
Obłożenie uniwersalne :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm
- 1 serweta na stół Mayo 145 x 78 cm
- 2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm x 75 cm
- 1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm
- 1 serweta z przylepcem 180 x 180 cm
- 1 taśma medyczna 50 x 9 cm
- 2 serwetki do rąk celulozowe 30,5 x 34 cm

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego ( zgodność z normą PN-EN13795), włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Chłonność 458 %. Odporność na penetrację płynów 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 141, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stołu Mayo 78 x 145 cm
- 1 osłona na kończynę 36x120cm
- 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 100x150 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 230 x 260 cm; wycięcie "U" 20x85cm, łąta chłonna 50x100cm i organizatory przewodów
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 x 300cm, z łątą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów
- 2 taśmy samoprzylepne 9 x 50cm

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 140g/m<sup>2</sup> (opisane jako łąta chłonna). Chłonność warstwy zewnętrznej 458%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami 990%. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 165 cm (H<sub>2</sub>O). Sterylizowane EO.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 142, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 2 taśmy samoprzylepnej 9x50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 143, dotyczy Pakietu nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 sterylnego pokrowca na przewody, rozmiar 17x240cm, wykonanego z folii o grubości 40µm, posiadającego elastyczną końcówkę i 2 taśmy do mocowania na końcówkach

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu nr 4 pozycje nr 17-19 i tworzy oddzielny Pakiet nr 24

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Pakiety nr 1 – 10, 23 / 33141110-4, Pakiety nr 11 - 20 / 33140000-3, Pakiet nr 21 / 33141000-0, Pakiet nr 22 / 33190000-8, Pakiet nr 24 / 33141110-4.

Punkt 7.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:

- 7.2.1. Karty danych technicznych bądź karty charakterystyki potwierdzające parametry zawarte w opisie produktu - dotyczy pakietów nr 2 - 4, 14, 15, 16 (poz.1-5), 17 (poz.1), 18, 21, 22, 24.
- 7.2.2. Dokumentu potwierdzającego właściwości bakteriobójczych w stosunku do szczepów MRSA, MRSE, VRE, PRSP – dotyczy Pakietu nr 23.
- 7.2.3. Deklaracji zgodności producenta dla wyrobu medycznego klasy III wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej poświadczającym właściwość klasyfikacji – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1 i 2.
- 7.2.4. Próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 szt., na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SIWZ) – dotyczy Pakietu nr 2 (poz.2-9), 3, 4, 15, 12 – 22, 24.

Zamawiający wymaga, aby każda próbka była wyraźnie oznaczona w taki sposób, aby było wiadomo jakiej pozycji w pakiecie dotyczy. Zamawiający wymaga oryginalnej etykiety produktu do każdej próbki.

Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest *dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych oraz wyrobów medycznych* na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 24 Pakiety:

| Nr pakietu | Nazwa pakietu                      |
|------------|------------------------------------|
| 1          | Plastry                            |
| 2          | Wyroby gazowe                      |
| 3          | Kompresy do sterylizacji oraz wata |

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 4  | Materiały opatrunkowe różne              |
| 5  | Gąbka hemostatyczna                      |
| 6  | Podkłady i podpaski                      |
| 7  | Opatrunki specjalistyczne I              |
| 8  | Opatrunki specjalistyczne II             |
| 9  | Opatrunki specjalistyczne III            |
| 10 | Opatrunki specjalistyczne IV             |
| 11 | Folia operacyjna oraz plaster fizelinowy |
| 12 | Serwety jałowe                           |
| 13 | Zestaw do zakładania szwów               |
| 14 | Obłożenia jałowe I                       |
| 15 | Obłożenie do cięcia cesarskiego          |
| 16 | Obłożenie uniwersalne i serwety jałowe   |
| 17 | Obłożenia jałowe II                      |
| 18 | Obłożenia jałowe III                     |
| 19 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony          |
| 20 | Zestaw zabiegowy                         |
| 21 | Ośłona na przewody                       |
| 22 | Zestaw do płukania kolana                |
| 23 | Gaza hemostatyczna                       |
| 24 | Siatkowy rękaw opatrunkowy               |

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.

**§ 4 pkt 8 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:**

Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną:) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27 adres e-mail: apteka@plockizoz.pl.

**§ 9 pkt 3 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania 30% wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet nr 3 - Kompresy do sterylizacji oraz wata**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                               | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | JM   | ilość | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat % | wartość brutto w PLN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1   | Kompresy do sterylizacji 10cm x 10cm 17n8w pakowane 100 szt., wielkość wykroju min 23 cm(+/-1cm) x 40 cm (+/- 1cm), waga jednego kompresu min 2,116g. Wymagana przędza tex min. 15        |           |                               | op.  | 1 500 |                        |                     | 8            |                      |
| 2   | Kompresy do sterylizacji 5cm x 5cm 17n8w pakowane 100szt., wielkość wykroju min 13 cm(+/-1cm) x 20 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min 0,598 g(+/- 0,3g). Wymagana przędza tex min. 15 |           |                               | op.  | 1 600 |                        |                     | 8            |                      |
| 3   | Kompresy do sterylizacji 7,5cm x 7,5cm 17n8w pakowane 100 szt., wielkość wykroju min 18cm(+/- 1cm) x 30 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min. 1,242g. Wymagana przędza tex min. 15      |           |                               | op.  | 5 100 |                        |                     | 8            |                      |
| 4   | Wata celulozowa biała w arkuszach (opakowanie max do 5 kg)                                                                                                                                |           |                               | kg.  | 1 400 |                        |                     | 8            |                      |
| 5   | Wata celulozowa w rolkach 150g                                                                                                                                                            |           |                               | szt. | 300   |                        |                     | 8            |                      |
| 6   | Wata opatrunkowa 200g/70% bawełna, 30% wiskoza                                                                                                                                            |           |                               | szt. | 50    |                        |                     | 8            |                      |
|     |                                                                                                                                                                                           |           |                               |      |       | Razem                  |                     |              |                      |

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet nr 4 - Materiały opatrunkowe różne**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip | nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | JM   | ilość  | cena jedn. Netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat % | wartość brutto w PLN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|--------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1  | Kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.               |           |                               | op.  | 21 000 |                        |                     | 8            |                      |
| 2  | Kompresy gazowe 10cm x 10cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.                 |           |                               | op.  | 12 000 |                        |                     | 8            |                      |
| 3  | Kompresy gazowe 5cm x 5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 19,5 cm x 11,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.                   |           |                               | op.  | 19 000 |                        |                     | 8            |                      |
| 4  | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 10 x 10 cm, pakowane po 10 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja parą wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15  |           |                               | op.  | 3 500  |                        |                     | 8            |                      |
| 5  | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 7,5 x 7,5 cm, pakowane po 10 szt. Wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja parą wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15 |           |                               | op.  | 2 100  |                        |                     | 8            |                      |
| 6  | Opaska dziana 10cm x 4m, pakowana pojedynczo                                                                                                                                                                                               |           |                               | szt. | 3 900  |                        |                     | 8            |                      |
| 7  | Opaska dziana 15cm x 4m, pakowana pojedynczo                                                                                                                                                                                               |           |                               | szt. | 1 100  |                        |                     | 8            |                      |

|       |                                                                                                                                                                                                  |  |  |      |        |  |  |   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|--|--|---|--|
| 8     | Opaska dziana 5cm x 4m, pakowane pojedynczo                                                                                                                                                      |  |  | szt. | 2 000  |  |  | 8 |  |
| 9     | Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m                                                                                                                                                                |  |  | szt. | 1 400  |  |  | 8 |  |
| 10    | Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m + dwie zapinki                                                                                                                                                 |  |  | szt. | 2 800  |  |  | 8 |  |
| 11    | Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągłości 85% i właściwościach kohezyjnych 10cm x 4m                                                                                                        |  |  | szt. | 300    |  |  | 8 |  |
| 12    | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut ,nawinięte na ekologiczną rolkę tekturową     |  |  | op.  | 30     |  |  | 8 |  |
| 13    | Opaska gipsowa 14-15 cm x 3 m , w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut ,nawinięte na ekologiczną rolkę tekturową |  |  | op.  | 30     |  |  | 8 |  |
| 14    | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 10cm x 3m                                                                                                                                         |  |  | szt. | 800    |  |  | 8 |  |
| 15    | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 15cm x 3m                                                                                                                                         |  |  | szt. | 1 000  |  |  | 8 |  |
| 16    | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 6cm x 3m                                                                                                                                          |  |  | szt. | 200    |  |  | 8 |  |
| 17    | Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejalowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wpleciona w gazę /Wymagana przęda tex min.15                                                                  |  |  | szt. | 22 500 |  |  | 8 |  |
| Razem |                                                                                                                                                                                                  |  |  |      |        |  |  |   |  |

# **UWAGA!**

\*W pozycjach 4, 5 zamawiający wymaga dla produktu naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej (naklejka zawiera kod produktu, numer serii, datę ważności i identyfikację producenta).

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 5.24 do SIWZ:

Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet nr 24 - Siatkowy rękaw opatrunkowy**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| lp.   | nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                               | Producent | nr katalogowy -<br>o ile dotyczy | JM   | ilość | cena jedn.<br>Netto w PLN | wartość<br>netto w PLN | stawka vat<br>% | wartość<br>brutto w PLN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1     | Siatkowy rękaw opatrunkowy udo, głowa, biodro w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min 50%                      |           |                                  | szt. | 5     |                           |                        | 8               |                         |
| 2     | Siatkowy rękaw opatrunkowy głowa, ramię, podudzie, kolano w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50%         |           |                                  | szt. | 7     |                           |                        | 8               |                         |
| 3     | Siatkowy rękaw opatrunkowy podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50% |           |                                  | szt. | 2     |                           |                        | 8               |                         |
| Razem |                                                                                                                           |           |                                  |      |       |                           |                        |                 |                         |

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEDYREKES ZARZĄDU  
*Marek Stawicki*  
Marek Stawicki

PROKURENT  
*Maja Kulesza*  
Maja Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/09PN/19 z dn. 22.02.2019  
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....

STARSZY INSPEKTOR  
*Maja Mikulska*  
Maja Mikulska

*H. Bogdan*

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

*Dagmara Bednarska*  
Dagmara Bednarska

